


Schemat przekazywania jednostki miary masy

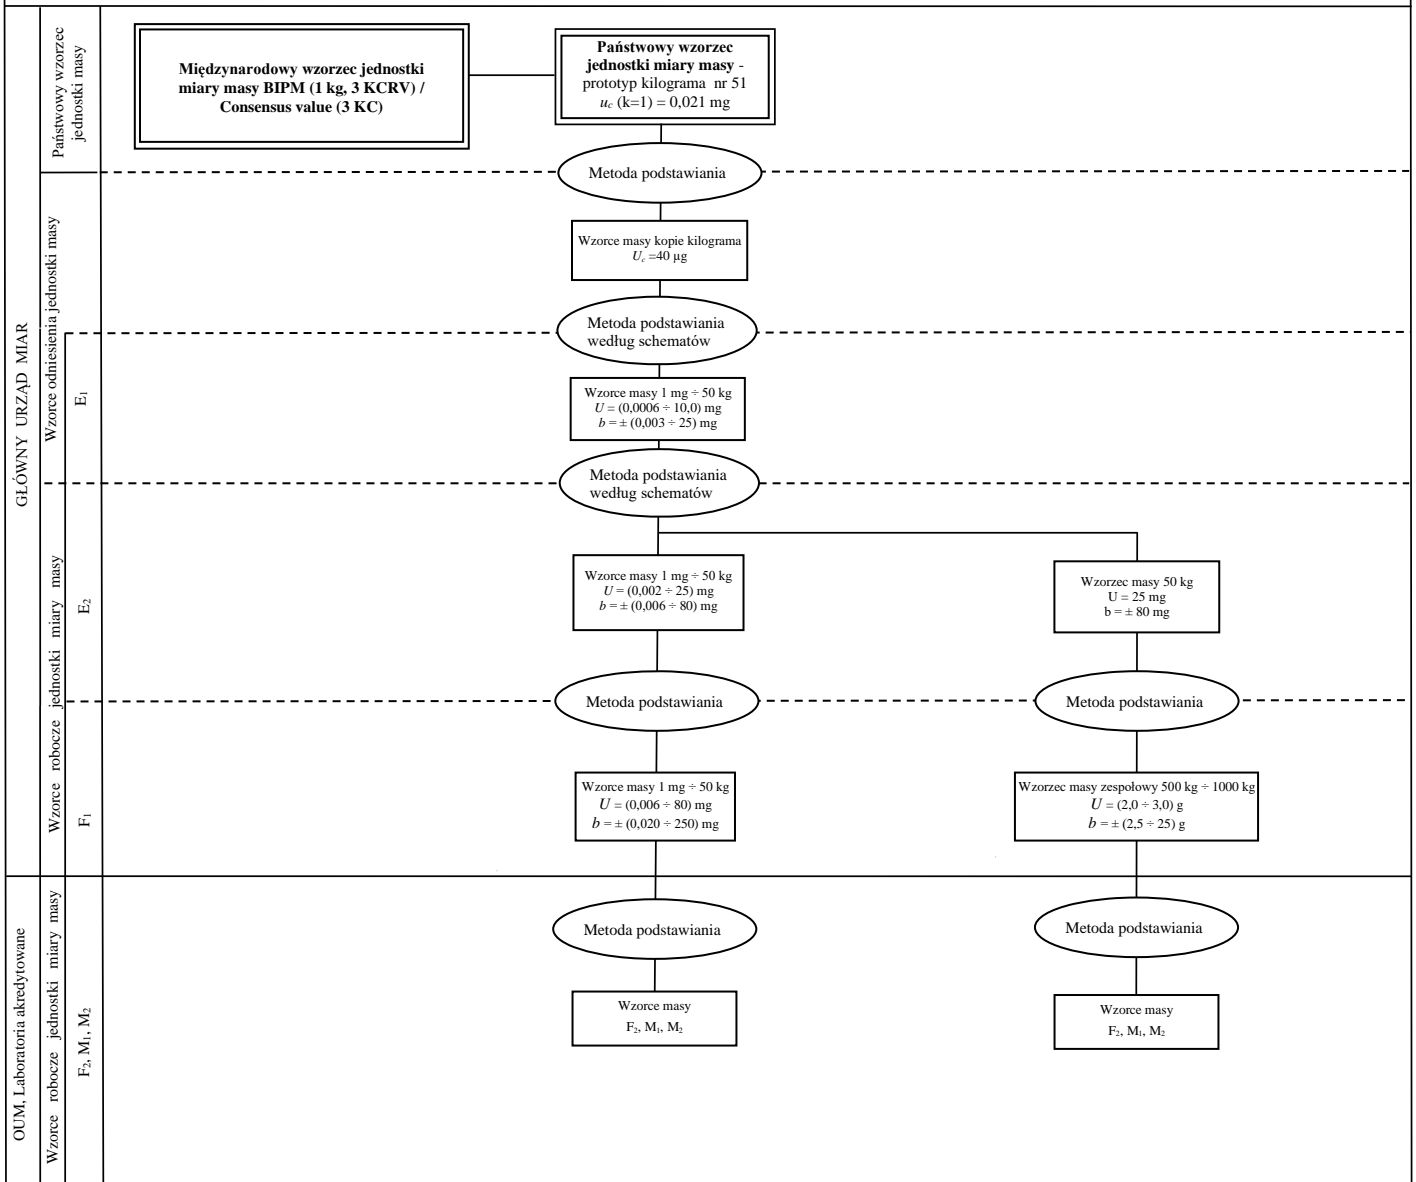

u_c – złożona niepewność standardowa

U – niepewność rozszerzona przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$

b – błędy graniczne dopuszczalne

Metoda podstawiania – wg OIML R 111

Metoda bezpośrednia – wg OIML R 76